



高雄榮民總醫院醫療儀器簡易操作說明

儀器名稱			
廠牌		型號	
序號		版本	
廠商		廠商電話	

設備部件說明：正面

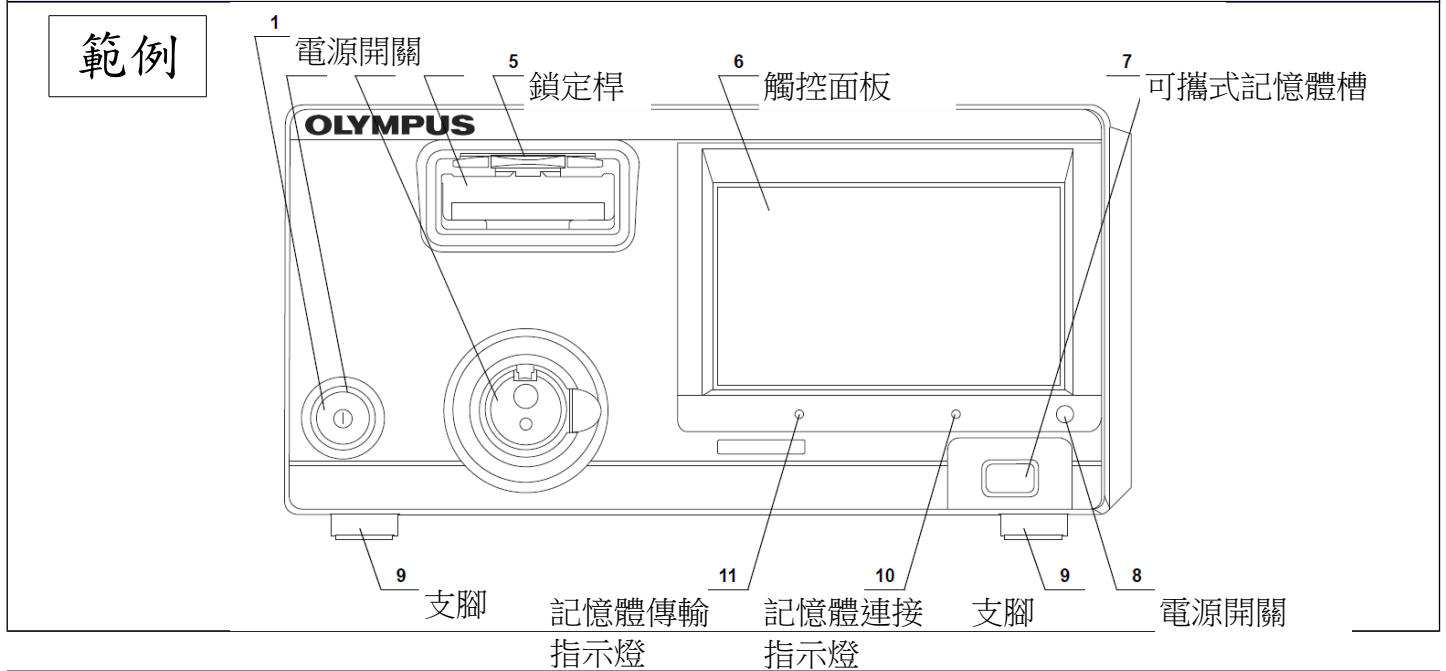

設備部件說明：背面

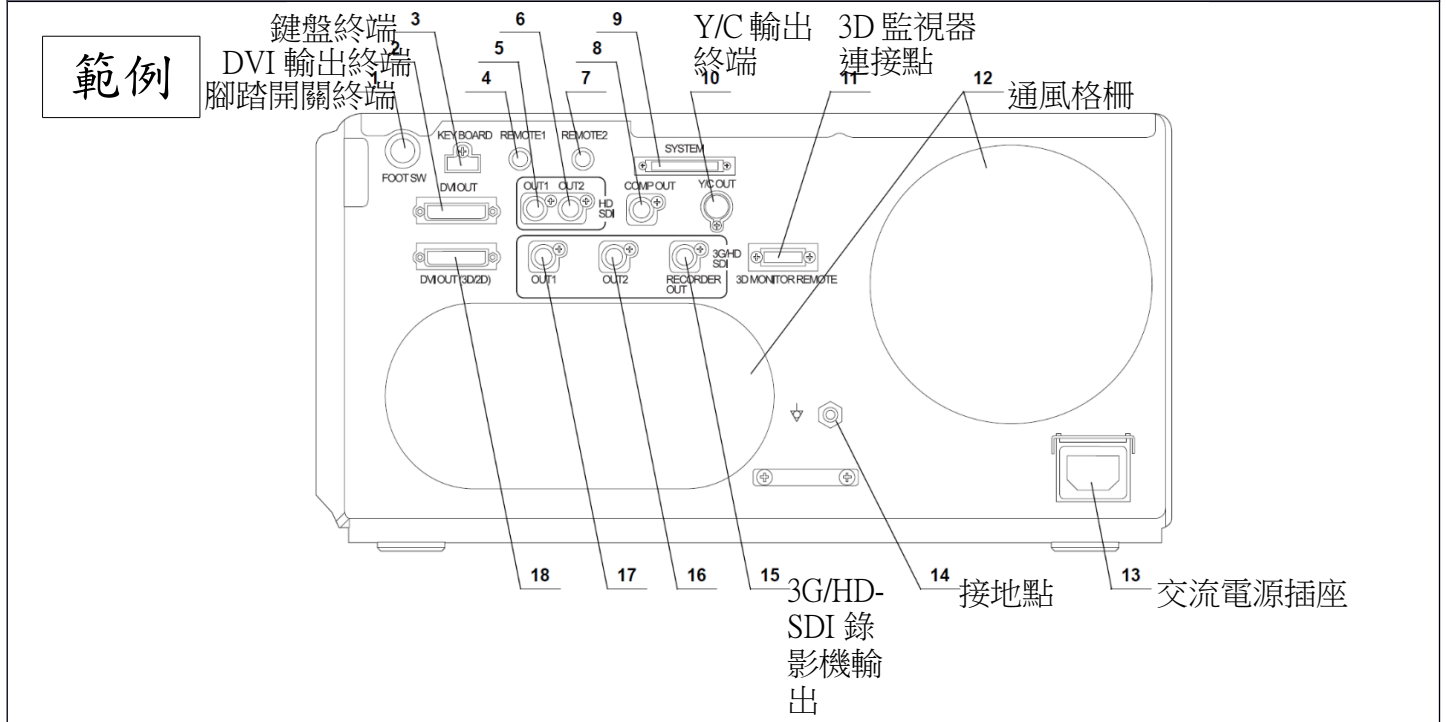

高雄榮民總醫院醫療儀器簡易操作說明

安全注意事項

範例

警告

- 嚴格遵守以下注意事項。否則可能會使患者和醫務人員觸電。
 - 當影像處理系統用於患者檢查時，請勿讓內視鏡或其附件的此類接觸可能導致患者意外觸電。
 - 請勿用濕手準備、檢查或使用影像處理系統。
- 絕對不可將高流量充氣單元安裝在以下場所作業：
 - 氧氣濃度高的場所；
 - 場所的空氣中含有氧化劑(例如一氧化二氮(N₂O))。
 - 場所的空氣中含有可燃性氣體；
 - 鄰近可燃性液體。

安全注意事項填寫說明

請依原廠手冊建議或衛部許可證仿單重點說明病人安全相關注意事項。

操作流程

文字+圖片說明，請放操作畫面或操作部件位置指示

操作流程填寫說明

可自行調整格式、說明方式，使操作程序說明順暢完整。